



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ

CNPJ: 22.980.643/0001-81 Responsável: SEMPLA Matrícula: 20008-1 Telefone: (91) 99384-7339
Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Relatório de Cotação: raio X Digital

Pesquisa realizada entre 17/07/2024 10:43:39 e 17/07/2024 10:44:39

Relatório gerado no dia 17/07/2024 10:46:35 (IP: 168.232.80.86)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: raio x



Descrição: aparelho de raio x fixo digital, conforme anexo ii do edital.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 16	1	R\$ 270.758,00 (un)	-	R\$ 270.758,00	100%	R\$ 270.758,00

Valor Global: R\$ 270.758,00

Valor do item em relação ao total

1) raio x

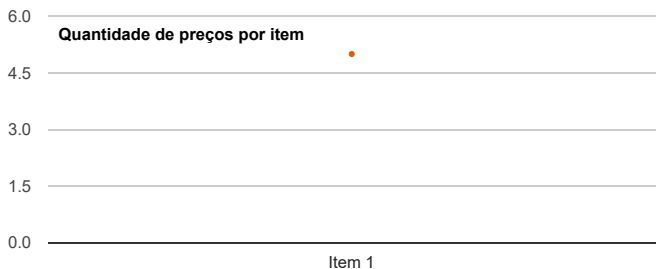

Detalhamento dos Itens



Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	aparelho de raio x fixo digital. conforme anexo ii do edital.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 277.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	00.394.429/0197-15	Data:	03/10/2023 09:00
Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de material permanente tipo Equipamento Hospitalar para atender às necessidades de diversas Seções do Hospital de Aeronáutica de Belém – HABE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	SRP:	SIM
Descrição:	Aparelho raios x - Corrente: Máximo De 800 MA, Aplicação: Fixo, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Adicional: Formato Dicom, Capacidade 1: Mínimo De 130 KG, Tipo: Digital, Tensão: Máximo De 125 KV,	Identificação:	NºPregão:892023 / UASG:120628
CatMat:	450494 - Aplicação: Fixo Tipo: Digital Adicional: Formato Dicom Corrente: Máximo De 800 MA Tensão: Máximo De 125 KV Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa Capacidade 1: Mínimo De 130 KG	Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.256.283/0001-85 *VENCEDOR*	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 181.000,00
Marca: KONICA MINOLTA Fabricante: KONICA MINOLTA Modelo: AltusDR NS Descrição: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – Gerador: Faixa de KV: 40 a 150 kV com intervalo de 1 em 1 kV/Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts Potência máxima: 64 kW/Faixa de mAs: 0,1 a 800 mAs/Faixa de mA: 10 a 800 mA/Tempo de exposição: 0,001 até 5s – Mesa: Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C)/Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm)/Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm)/Altura do tampo: 83 cm/Capacidade de trabalho: 220 kg/Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm/Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal)/Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm/Foco: 100 a 180 cm/Grade: fixa antidifusora 10:1 – 103 linhas/polegada - Bucky Mural: Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm)/Freio do movimento do bucky: mecânico/Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm/Foco: 100 a 180 cm/Grade: fixa antidifusora 10:1 – 103 linhas/polegada - Estativa Porta Tubo: Deslocamento longitudinal: ± 185 cm (total de 370 cm)/Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm/Freio dos deslocamentos: eletromagnético/Tipo chão-chão/Rotação da coluna: 360º/Rotação do braço do tubo: 180º/Giro da cúpula: ± 180º - Tubo E7252FX: Tensão máxima: 150 kV/Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso)/Potência referência do anodo: 27 kW (foco fino) / 75 kW (foco grosso)/Capacidade térmica do anodo: 300 kWh (210 kJ)/Rotação do anodo: 9.700 rpm - Detector AeroDR: Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si)/Modelo: AeroDR NS 14x17"/Conexão com o equipamento: AeroSync/Área útil: 14x17" (35x43 cm)/Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (CsI)/Matriz ativa: 2304 x 2800 pixels (6,4 milhões de pixels)/Tamanho do pixel: 150 µm/Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza)/Pré-visualização da imagem: 4 segundos ou menos/Tempo de ciclo: 10 segundos ou menos/Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 150 kg e 100kg sobre uma área de 40 mm/Bateria de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 5,9 horas de exames ou 212 imagens/Tempo de recarga: 3 horas/Peso do detector: 3,6 kg com bateria Console de Operação ImagePilot: Plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, a aquisição digital de imagens, o fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens tudo em um único sistema. A função AutoPilot permite a aquisição com processamento automático da imagem sem necessidade de especificar o tipo de exame que será realizado e corrige erros de técnica eliminando a necessidade de repetições. CPU - Core i3 – 8 GB de RAM – 1 TB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse/Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens/Monitor de 23 polegadas touchscreen (2MP)/Conectividade DICOM 3.0/DICOM Print/DICOM Storage/DICOM MWM para conexão RIS e HIS/Drive CD/DVD para gravação de mídia externa/Conversão da imagem para formato JPEG/Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB)/Processamento manual ou automático das imagens/Eliminação das linhas de grade/Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres/Medidas de distância e ângulo/Magnificação (zoom) da imagem/Visualização em tela cheia/Rotação, movimentação e inversão da imagem/Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho/Escurecimento automático da imagem (máscara)/Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário/Impressão de até 25 imagens por película/Acesso ao sistema através de login e senha/Armazenamento de até 200 imagens no detector CONFIGURAÇÃO GERAL – QTD DESCRIÇÃO 1 Equipamento de Raios X Digital Modelo AltusDR/ANVISA 80101380017/Fabricante/Marca Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda/Procedência Brasil 1Tubo E7252FX – 150 kV/1 Controle Automático de Exposição (AEC)/1 Dispositivo de medição do produto área-dose (DAP)/1 Par de cabos de alta tensão/1 Painel AeroDR NS 14x17" com conexão AeroSync/1 Battery Charger NS/2 Baterias/1 Console de operação ImagePilot (CPU, mouse e teclado)/1 Monitor de 23 polegadas touchscreen (2MP)/1 Ano de garantia ITENS ADICIONAIS QTD DESCRIÇÃO 1Image Pilot Media Output Option/1RAM de 8GB / HD de 1TB/1Licença de Stitching para software ImagePilot/1Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (1 kVA)/1Autotransformador para tensão 220V/6Mese(s) de garantia adicional		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Nova Lima	RUA STAR, 420



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 183.000,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: LOTUS Modelo: HF630M DR DIGITAL Descrição: Conjunto radiológico Digital, modelo HF630M DIGITAL, fabricante/marca Propria, capacidade de 150KV/50KW/630mA, composto de : mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequencia e comando e demais acessórios para instalação.Tensão de alimentação 220/380VAC TRIFÁSICO AC / 60Hz,multipulso alata frequência; Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6 / 1.2 mm. Sistema de aquisição de imagem digital tipo DR Flat panel sem fio (WIFI), com estação de trabalho, monitor e demais acessórios inclusos; Demais características e componentes conforme edital.Garantia de 18 meses. Registro na ANVISA nº 80123860005. Validade da proposta de 120 dias.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Pato Branco	AVENIDA ELISA ROSA COLLA PADOAN, 45
12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 187.000,00
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: INNOVISION DX II Descrição: Fabricante: Propria Marca: Imex; Modelo: Innovision Dx - II; Procedência: Brasil; Validade da Proposta: 120 dias Prazo de Entrega: 30 dias Condições de Pagamento: 30 dias Garantia do Equipamento: 18 meses		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São José	R DAS EMBAUBAS, 601
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 249.900,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: VMI TECNOLOGIAS Modelo: APOLO D Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL – MODELO APOLO D – REGISTRO ANVISA: 81583780001 - CÓDIGO FINAME: 3538246 – MARCA PROPRIA – PROCEDÊNCIA NACIONAL. O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo. COMANDO E GERADOR O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE De modo nativo, o painel de operação do conjunto radiológico APOLO D é integrado ao sistema de imagem de forma que todas as indicações e seleções técnicas aplicadas na realização do exame serão mostradas no monitor em conjunto com a imagem adquirida (kV, mA,mAS). O conjunto radiológico APOLO D possui sistema de medição de dose aplicada no paciente (PDA) durante a exposição radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição (mGy) e também a dose total aplicada em todo o exame. O registro de doses é gravado em cada imagem digital DICOM. PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 1.152 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. INTERFACE DE COMANDO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS Interface de comando e manipulação de imagens para aquisição, armazenamento e manipulação de imagens digitais. Características: Modelo: Estação de Trabalho Fixa. Memória RAM: 16 GB DDR4. Processador: Intel Core i7 de 10ª geração. Tamanho do Monitor: 24 polegadas. Resolução: Full HD – 1920x1080 pixels (2 MEGAPIXELS). Disco Rígido (HD): SSD 1 TB para armazenamento de 70.000 imagens DICOM aproximadamente. DADOS RADIOLÓGICOS Potência do gerador: 50 kW. Alimentação trifásica 380 Vac – 50/60 Hz Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos de 1kV. Faixa de corrente radiográfica de 10 a 800 mA (É possível configurar para máxima corrente de 630 mA). Foco Fino: 10/20/25/32/40/50/64/80/100/125/160/200/220/250mA (Configurável); Foco Grosso: 280/320/400/500/630/800 mA (Configurável). Faixa de tempo exposição de 1ms a 5s (em conformidade com a RDC 611/2022). Variação da faixa de mAs: 0,1 a 800 mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO - MODELO CHÃO-CHÃO MESA BUCKY - MODELO TAMPO FLUTUANTE MURAL BUCKY - O modelo mural bucky proporciona movimentos leves e suaves. De posicionamento rápido e fácil agiliza a realização dos exames. Movimento vertical para ajuste de altura da região de interesse; Variação de deslocamento vertical: 160 cm. DETECTOR DIGITAL Modelo Sem Fio 35 x 43 cm ou 14X17 pol Permite realização de exames no bucky do mural, bucky da mesa e exames fora dos bucky's (Em macas, cadeiras de rodas, exames pé com carga e muito mais). Adaptável aos equipamentos de raios X sem que haja a necessidade de alteração. ACESSÓRIOS: NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE IMAGENS. DESCRITIVO COMPLETO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS NA PROPOSTA ANEXA. VAL. DA PROPOSTA DE 120 DIAS. ENTREGA EM ATE 30 DIAS. GARANTIA INTEGRAL DE 18 MESES. PAGAMENTO EM 30 DIAS.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Lagoa Santa	R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, 400



04.864.204/0001-21 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA R\$ 250.000,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: PROPRIO

Descrição: APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO FIXO DIGITAL Especificações técnicas: Comando e Gerador de Alta Tensão Potência de 50kW Alimentação 220VAC ou 380VAC +/- 10%, 50/60Hz, trifásico Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio do ânodo Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs Pannel de membrana com teclas de simples toque Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso Saída no comando para acionamento de lâmpada indicativa na porta da sala de RX Bloqueio do disparo com porta aberta Disparo em 2 estágios APR 534 posições (Programa anatómico de órgãos), por região Seleção automática de foco fino e grosso Ajuste de kV de 30 – 150kV em passos de 1kV Variações de mAs de 0,1 – 650mAs em 39 passos programadas por software Tempo de exposição de 0,001 – 5 segundos programavel Ajuste de mA de 10 – 650mA em 19 passos programadas por software Ajuste automático de rede +/- 10% Seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. Par de cabo de alta tensão com 7 metros, 150kV. Tubo de Raios X Unidade selada imersa em óleo isolante e revestida em chumbo Focos 0,6 – 1,2mm Rotação do ânodo 3200RPM Índice Calorífico do Ânodo 300kHU Índice Calorífico do Conjunto do Tubo de Raios-X 1250kHU Ângulo do Ânodo 16° Potência de Entrada Nominal do Ânodo 22,5/47kW Coluna Porta Tubo Tipo teto-chão giratória +/-180° Deslocamento longitudinal de 250cm Deslocamento vertical de 49 a 205cm Movimento giratório conjunto tubo-colimador +/- 180° Braço telescópico de 19cm Indicação SID de 1,0 – 1,8m no trilho Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal Estrutura de aço e pintura eletrostática Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 220cm de comprimento x 85cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de +/-31,1cm e longitudinal de +/-70cm Deslocamento do bucky 48cm Pedal para liberação dos freios eletromagnéticos para todos os movimentos Grade antidifusora fixa 10:1 40 linhas/cm. SID 1,0m Trilhos para utilização de faixa de compressão Bandeja para detector digital em todas as posições Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática Suporte de parede (bucky mural) Freio mecânico Grade antidifusora fixa 10:1 40 linhas/cm Bandeja para detector digital em todas as posições Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente SID 1,0m - 1,8m Altura do eixo horizontal do receptor: máxima de 178cm e mínima de 36,5cm Estrutura de aço e pintura eletrostática Colimador Luminoso Colimador manual, ajustável para indicação da área irradiada Temporizador de 30 segundos para desligamento automático Filtração inerente 2mm Al Iluminação 100 Lux a 1m Detector Digital (DR) 01 detector digital – DR, WIFI Camada de Conversão de Raios-X - Iodeto de Césio (CsI) com Fotodíodo de Silício Amorfo (a-Si) Medida 35 x 43cm Matriz de pixels 3500 (H) x 4300 (V) – 15MP Tamanho do pixel 100µm Resolução-Limite 4,3lp/mm typ Conversão A/D (profundidade de aquisição) 16bit Peso suportado de 300Kg distribuídos e 150Kg concentrado em 4cm X 4cm Proteção IP56 Acompanha: 2 baterias de lítio 1 carregador de baterias 1 cabo de comunicação 1 fonte para uso sem baterias Possibilidade de digitalizar outros equipamentos Software de aquisição de imagens PrimoS Comunicação DICOM DICOM Print Distribuição de imagens através de PACS, HIS/RIS ou impressora Lista de trabalho (Worklist) para consulta de pacientes Armazenamento (Storage) para verificação da fila de trabalho do dispositivo de armazenamento Registro de pacientes manualmente, via worklist ou emergência Edição dos dados do paciente Inserção de comentários fixos ou manualmente pelo operador Divisão de tela para comparação de imagens Ferramentas de medição – reta e ângulo Supressão das linhas da grade automática Imagem “negativa” Girar ou inverter imagem Recortar imagem Ajuste e contraste e brilho e latitude individualmente Filtros diversos Magnificação da imagem Pré-vizualização Aquisição de imagens em até 3s e processamento da imagem em até 6s após exposição Escanometria, coluna total e membros inferiores automático, por pontos ou manualmente Estação de trabalho Monitor para visualização da imagem de 21" resolução FULL HD Exportação de imagens para gravar em CD/DVD PC processador Intel i5 Memória RAM de 8GB Windows 10 Pro HD de 1TB com possibilidade de armazenamento de 25.000 imagens

Estado: SP Cidade: Diadema Endereço: RUA ORENSE, 783

58.598.368/0001-83 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA R\$ 304.000,00

Marca: LOTUS
Fabricante: LOTUS
Modelo: CONJUNTO HF 630M DR + PLACA DR CSI 3643VW

Descrição: APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL Conjunto radiológico de 125KV/50KW. Tensão de alimentação 380 VAC, Trifásico AC 60HZ, Com faixa de KV de 40 KV a 150 KV, com passos de ajuste de 1 KV em 1kV. Com faixa de mA 10 a 630 mA (20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630mA). Faixa de mAs 0,25 a 630 mAs. Tempo de exposição 0,001 a 6,3 seg. Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA). Máxima corrente de 630 mA. Maior potência de saída 50KW. Foco Fino de 0,6 mm e Foco Grosso de 1,2 mm. Velocidade do anodo de 3.200 RPM. Tensão máxima tubo 150 kV. Máxima capacidade de acumulação térmica 300 KHU. Potência nominal do anodo 22/54KW (Foco Fino e Grosso respectivamente); Teclas pannel de comando tipo micro switch/luminosa opcional/membrana. Dimensões do tampo 90 x 227 cm, tipo tampo / mesa flutuante, deslocamento longitudinal do tampo +/- 68 cm (136 cm total); Deslocamento transversal do tampo +/- 23 cm (46 cm total); Dispositivo centralizador chassi bucky mesa; Bucky mural ou de mesa que suporte chassis/cassetes/painéis de 35x43cm, Freios do movimento do tampo através do pedal eletromagnético; Freio da mesa eletromagnético; Peso suportado pela mesa 300 Kg; Grade de mesa fixa ou oscilante com resolução adequada ao detector (Para Bucky mural e Bucky mesa); Deslocamento vertical da estativa bucky mural de 40 a 190 cm a partir do chão; Freio deslocamento vertical bucky mural eletromagnético ou mecânico; Grade de mesa fixa ou oscilante com resolução adequada ao detector; Suportar o tamanho de cassete de 43 x 43 cm. Foco Filme bucky mural 100 a 180 cm e bucky mesa 100 cm. Coluna/Estativa porta tubo para fixação no chão de 2,80m. Deslocamento longitudinal da estativa porta tubo manual 180cm. Freio para estativa porta tubo tipo eletromagnético. Deslocamento vertical do braço porta tubo manual de 150 cm. Freio deslocamento vertical porta tubo eletromagnético. Rotação da coluna estativa porta tubo de 180 graus. Freio de rotação da coluna estativa porta tubo manual acionado por botão no porta-tubo ou similar. Giro do tubo de Raio-X ao redor do eixo do suporte do braço +/-90° (movimento rotacional). Freio de giro do tubo de raio x eletromagnético. Indicação de ângulo luminoso por gravidade. Seleção de Bucky. Indicação de todos os parâmetros/funções no display (kV, mA e mAs). 01 (uma) Unidade de Detector Digital de Raios – X do tipo DR, Detectores de campo total com baterias removíveis e conexão para transmissão de imagens sem fio (wireless) e adaptável aos equipamentos de Raios-X analógicos sem que haja necessidade de alteração. Detector de estado sólido do tipo flat panel. Conversor TFT de Silício Amorfo e Cintilador de Iodeto de Césio. Área ativa de 35 x 43 cm (14x17 pol.) com razão de conversão de 100%. Além da bateria integrante do detector, acompanhará 01 unidade de bateria extra, por detector, sendo que cada bateira tem autonomia de 1.500 imagens ou 7,5 (quatro) horas de uso por carga – o que ocorrer primeiro. 01 (um) carregador de bateria por detector; Matriz efetiva de pixel de 2560 X 3072 pixels. "Dynamic Range" de 16 bits/pixel. Tamanho de Pixel de 140 µm (micrometros). Peso de 3,3 Kg com bateria. Adaptável em qualquer sistema “bucky” para que não necessite alterações no sistema de raios-X. Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 400 Kg. Tecnologia de detector de campo total Flat Panel. Totalmente compatível com Dicom 3.0. A imagem gerada no detector será transmitida para o console através conexão Wireless (sem fios). A imagem será gerada e transmitida em 7 segundos e no formato de imagem DICOM. Acompanha estação de trabalho / Aquisição para captura da imagem gerada pelo digitalizador e visualização da imagem. Acompanha Microcomputador com capacidade e desempenho compatível com a necessidade do sistema. Possui Sistema Operacional Windows com licença de uso. Monitor de LCD sensível ao toque com dimensão de 23 polegadas e matriz mínima de 1920x1080 pixels. Memória local de 8 Gb. Disco rígido local de 1.000 Gb (1Tb). Capacidade de conexão LAN Fast Ethernet. Além das características acima o sistema contém as seguintes aplicações: Algoritmo de processamento da imagem direta (raw image) multi-frequencial por contraste para radiologia geral. Colimação e enegrecimento automático e manual via "software" específico. Possibilidade de configuração pelo usuário dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatómicas. Serviços Dicom 3.0: Storage, Print, Worklist Management, Commitment e MPPS. Possibilidade de manipulação pelo usuário de Latitude, Contraste e Brilho independentemente. Possibilidade de realização de medidas de distância e ângulos pelo usuário nas imagens adquiridas. Possibilidade de inserção de figuras, textos fixos e editados pelo usuário. Possibilidade de aplicação de zoom de 100%. *** ESPAÇO INSUFICIENTE

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA MARIA CASALI BUENO, 57



19.769.575/0001-00 NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. R\$ 417.197,00

Marca: VMI
Fabricante: VMI
Modelo: APOLO D
Descrição: APOLO D - O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo. COMANDO E GERADOR O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE De modo nativo, o painel de operação do conjunto radiológico APOLO D é integrado ao sistema de imagem de forma que todas as indicações e seleções técnicas aplicadas na realização do exame serão mostradas no monitor em conjunto com a imagem adquirida (kV, mA,mAS). O conjunto radiológico APOLO D possui sistema de medição de dose aplicada no paciente (PDA) durante a exposição radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição (mGy) e também a dose total aplicada em todo o exame. O registro de doses é gravado em cada imagem digital DICOM. PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 1.152 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's. O conjunto radiológico APOLO D disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento); Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente; Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente; Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs); INTERFACE DE COMANDO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS Interface de comando e manipulação de imagens para aquisição, armazenamento e manipulação de imagens digitais. Características: Modelo: Estação de Trabalho Fixa. Memória RAM: 16 GB DDR4. Processador: Intel Core i7 de 10ª geração. Tamanho do Monitor: 24 polegadas. Resolução: Full HD – 1920x1080 pixels (2 MEGAPIXELS). Disco Rígido (HD): SSD 1 TB para armazenamento de 70.000 imagens DICOM aproximadamente. Sistema Operacional: Windows 11 Professional Edition 64 BITS. Acessórios: Roteador Wireless – Dedicado Placa de vídeo 2 GB – Integrada Teclado e Mouse USB Placa de Rede tipo Ethernet 02 portas USB disponível Software de Aquisição e Manipulação de Imagens Médicas Digitais: Software Especializado em Radiologia Digital, para aquisição, armazenamento e manipulação de imagens digitais. Características: Principais Ferramentas: ESCANOMETRIA/ Radiografia Panorâmica: permite a visualização e diagnóstico de grandes áreas através da junção de duas ou mais imagens para formar uma imagem única (exemplo: imagens de coluna completa, membros inferiores e corpo inteiro); Permite impressão em impressoras DICOM e/ou impressoras a papel com possibilidade de customização do layout e informações a serem impressas. Ferramentas de tratamento de imagens: Filtros específicos para diferentes regiões anatômicas. O software sugere 9 filtros pré-definidos para a cada imagem adquirida, para seleção do melhor parâmetro de acordo com a preferência do usuário; Inversão das cores de imagens (imagem negativa); Aplicação de zoom localizado (lupa) e zoom total; Ajuste automático do tamanho da imagem à tela; Ajuste de Brilho e Contraste com apenas um clique no mouse (de forma independente); Função de reset da imagem, possibilitando desfazer as edições e retornar à imagem original; Colimações retangulares e circulares de tamanhos livres ou pré-definidos; Ferramenta para cópias das imagens; Espelhamento de imagens nos sentidos Vertical e Horizontal; Rotação de imagens em 90° para Direita e Esquerda (latitude);

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** TV WE-12 (CJ SATELITE), 1000

08.546.929/0003-94 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS R\$ 431.000,00
LTDA

Marca: Carestream
Fabricante: Carestream
Modelo: DR Compass
Descrição: Item 02 – Aparelho de Raios X digital. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de 65kW. Tensão variável: faixa de 40kV a 150kV. Corrente variável na faixa mínima de 10mA a 800mA; 0,1 a 800 mAs. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso de 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 3200 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo de 300 Khu. Inserção de filtros adicionais de AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal superior a 300 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/- 90 graus com travas cem 0 graus,+/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de 103lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 10:1; Tampo flutuante de 216x90 cm, com curso total de deslocamento longitudinal de 77 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 30 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de 295kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro de grade entre 34cm e 169cm a partir só chão, aproximadamente, dotado do sistema de freio eletromagnético. Mural com grade antidifusora de 103lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com laser de centralização integrado para posicionamento / localização. Detector plano com dimensões aproximadas de 35x43cm. Detector DR Focus sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, possibilitando exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de 2304 x 2800 pixels. Profundidade da imagem pósprocessada de 16 bits. Tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros. O equipamento possibilita a manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatíveis com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução de 23 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens; Memória RAM de 500 GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 10.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Possui processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, DAP, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem; e execução de exames de panorâmica de coluna total com junção automática de imagens e Alimentação elétrica 380V; No break incluso. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. Prazo de Entrega: 90 dias. Prazo de Validade da Proposta: 120 dias. Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estamos de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. Prazo de Garantia: Conforme edital; 18 meses a partir da instalação ou disponibilização do equipamento. Não estão cobertos pela garantia defeitos causados por mau uso ou operação indevida da solução.

Estado: MG **Cidade:** Varginha **Endereço:** R CITLOG, 333



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 499.000,00
Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo: HF 630M DR Descrição: Raios X Digital Modelo DR HF630M Marca Lotus, com placa de captura direta 140 microns com Registro único na Anvisa(ou seja, equipamento DR nativo e integrado de fábrica – aparelho e placa DR – ambos registrados na Anvisa como conjunto DR). Reg. Anvisa: 80123860005. Equipamento direcionado para exames da radiologia geral; Gerador de raios-x Multi-pulso com potência nominal de 50KW e máxima de 55KW, Painel de controle; Tubo de Raios-X 300 KHU;Estativa porta-tubo; Bucky mural; Mesa com tampo flutuante; Permite técnicas de Raios X nos modos Manual e Automático, Alarmes para falhas, Sistema digital com detectores de silício Amorfo e tela de conversão de Iodeto de Césio (CSI) Tamanho do pixel 140 microns; Profundidade de imagem de 16 bits/pixel; Gerador de Alta-frequência, microprocessado, Potência máxima de 55KW, Tensão de 40-150 kV, corrente de 10 a 630 mA; 0,25 a 630 mAs; Proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Painel de controle Indicação digital de kV, mA, Sistema independente para ajuste do operador; Seleção de foco Fino e Grosso; Tubo de Raios-X, foco fino/grosso 0,6/1,2 mm e capacidade térmica de 300kHU – 3200 rpm; Estativa: Vertical ; Movimentos com o tubo de raios-x: Coluna com deslocamento longitudinal de 296,10cm,Vertical 158,60 cm e altura máxima de 244 cm, Rotação de ± 180°, para exposições no bucky mural e projeções oblíquas na mesa retentores mecânicos nas posições 0°, ±45° e ±90°.Rotação da coluna toda ou do braço porta-tubo em ± 180°; Angulador do tubo digital; Freios eletromagnéticos para todos os movimentos; Grade antidifusora 103 linhas/pol.; Marcação em cruz para centralização do paciente; Sistema de freios eletromagnéticos. Montagem chão-chão ou chão-teto. Mesa para Diagnóstico: Tampo flutuante: deslocamento nos 04 sentidos; Sistema de freios eletromagnéticos acionado por pedal; dimensões 227,5 cm x 91 cm; Capacidade de carga da mesa de 300 Kg; Permite os seguintes movimentos do tampo: Longitudinais de +-68 cm(total 136 cm);Laterais de 23,6 cm (total 47,20 cm);Distância foco/detector de 100 cm a 180cm;Colocação frontal de chassi ou detector;Grade antidifusora 103 linhas/pol – proporção 10:1; Estação de aquisição: Estação HP profissional - Processador i5, 3.6 GHz, placa de vídeo / 8GB Ram – SSD 250 GB+ 1TB SSD , , CD/DVD – capacidade armazenamento temporário acima de 20000 imagens, placa de rede 10/100/1000 T-Ethernet, portas USB, teclado e mouse, 01 monitor de 24" de alta resolução touch screen. 01 Placa Detectora Digital - painel plano (FPD): detector de silício Amorfo e tela de conversão de Iodeto de Césio (CSI) marca Vieworks, modelo VIVIX S 3643 VAW; Dimensões da área útil de aproximadamente 35 cm x 43 cm; Profundidade de imagem de 16 bits/pixel; Peso do detector – 3,20 kg aproximadamente, incluindo a bateria; Excelente Resolução de 140 microns; suporta 200 KG pontuais ou 400 KG distribuídos. Possui grau de proteção IP67 – o maior do mercado. Memória interna para 200 imagens. 02 baterias internas de longa duração, proporcionando acima de 15 horas ininterruptas de operação. As baterias podem ser facilmente retiradas, recolocadas e trocadas, caso necessário. Unidade Bucky Mural, com as seguintes características: Dimensões: Altura: 2245 mm (88,39 pol.) Largura: 651 mm (25,63 pol.) Profundidade: 367 mm (14,45 pol.) Altura mínima do centro do detector: 335 mm (13,19 pol.) Altura máxima do centro do detector: 1850 mm (72,83 pol.) Movimento vertical do bucky: 1520 mm (59,84 pol.) Absorção de radiação (atenuação do painel frontal, excluindo o AEC): < equivalente a 0,7 mm Al. Ângulo do bucky (bucky basculante) -20° a +90°. Grades anti espalhamento: grade paralela e grades com foco de 103 l/pol., proporção 10:1 distâncias focais 100/150/180 cm (39.37/59.06/70.87 pol.). Carga máxima no bucky mural: 32 kg (70,54 lb.) SOFTWARES DA ESTAÇÃO: DICOM STORE (Arquivamento e envio de imagens brutas - raw data, e pós processadas) Recurso de envio automático de imagens para sistemas PACS; DICOM PRINT(impressão), CD EXPORT(gravação de imagens em CD/DVD com viewer integrado); DICOM MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP, MULTI-LAYOUT DE IMPRESSÃO, DICOM COMMITMENT; DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT, RISLINK – Conexão RIS/HIS, NX OPTVIEW GRID LINE SUPPRESSION - Eliminação de linhas de grade; NX SQUARE MARKER - Identificação de alteração de posicionamento; BLACK BORDER - enegrecimento automático de bordas; Contém as licenças de régua, medição de ângulos, anotações especiais, etc. Exames de emergência sem obrigatoriedade de inserção dos dados do paciente; Possibilidade de login e senha individuais para os usuários, mediante cadastro. Registro do paciente manual e através de worklist, com possibilidade de iniciar exame emergencial sem registro. Possibilidade de editar dados do paciente depois de cadastrado. Ferramenta de anotação em texto livre e pré programado. CONTINUA NA PROPOSTA		
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187

18.932.464/0001-00	K R G BENTO EIRELI	R\$ 946.666,67
Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo: CMOS DRAKE Descrição: Corrente: Máximo De 800 MA, Aplicação: Fixo, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Adicional: Formato Dicom, Capacidade 1: Mínimo De 130 KG, Tipo: Digital, Tensão: Máximo De 125 KV		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 798

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 299.990,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SALVADOR - PMS / (2) SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	Data: 14/05/2024 09:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X FIXO DIGITAL.	Modalidade: Pregão
Descrição: RAIOS X - APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL. CONFORME ANEXO II DO EDITAL.	SRP: SIM
	Identificação: NºLicitação:1044532
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/07/2024 13:00
	Homologação: 08/07/2024 13:00
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 5
	UF: BA



02.659.246/0001-03 VMI TECNOLOGIAS LTDA. R\$ 234.300,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL - CÓDIGO 100006456. Marca/Fabricante: Própria. Modelo: APOLO D. Procedência: NACIONAL. Registro ANVISA: 81583780001. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias. PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos. PRAZO DE GARANTIA: 24 meses. O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios X. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios X em produção no mundo. Desempenho: A ênfase no desempenho sugere que o APOLO D oferece resultados rápidos e precisos, atendendo às demandas de qualidade e eficiência em imagens radiológicas. Alta Resolução de Imagem: A capacidade de fornecer alta resolução de imagem é crucial para a visualização nítida de detalhes anatômicos, o que é fundamental em diagnósticos médicos. Potência: A referência à potência pode indicar a capacidade do sistema de gerar feixes de raios X suficientemente fortes para penetrar através dos tecidos e criar imagens claras. Segurança: A segurança é fundamental em sistemas de raios X para proteger pacientes e operadores contra exposição excessiva à radiação. Isso pode envolver tecnologias de dose mínima e recursos de segurança integrados. Interatividade: A interatividade sugere a presença de recursos que possibilitam a interação fácil e eficiente do operador com o sistema, proporcionando uma experiência de uso mais intuitiva. Produtividade: A busca pela produtividade destaca a eficiência operacional do APOLO D, indicando que o sistema é projetado para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a eficácia na produção de imagens. Design Moderno: O design moderno é uma característica estética e indica a incorporação de elementos ergonômicos para melhorar a usabilidade e a integração com ambientes de saúde contemporâneos. Recursos Tecnológicos de Eletrônica e Software: Os recursos tecnológicos de eletrônica e software que possui o APOLO D integram inovações recentes, tanto em hardware, firmware e, também, em software, para melhorar a qualidade e a eficiência das imagens. O APOLO D é um sistema abrangente e moderno que visa proporcionar alta qualidade de imagem, segurança, eficiência e facilidade de uso. Aparelho de raios X fixo digital nativo de uso geral, ideal para a realização de exames do sistema esquelético e pulmonar. Permite capacidade de realizar exames em pé, cadeira de rodas, na maca, deitado dorsal, lateral, ventral na mesa, exames de tórax, coluna, crânio, extremidades em geral, entre outras. COMANDO E GERADOR O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBTs, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBTs e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. Controle por Microprocessadores: O uso de microprocessadores para controlar e supervisionar todas as funções do conjunto comando e gerador de alta tensão sugere uma abordagem digital e programável, proporcionando maior flexibilidade e precisão no controle do sistema.(...) Descrição técnica completa em proposta anexada.

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Lagoa Santa	R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, 400

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R\$ 299.990,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DR HF800M DIGITAL Marca Lotus, Equipamento nativo digital direcionado para exames da radiologia geral, Registro único na Anvisa com manuais na Anvisa certificando o equipamento com a placa relacionada, e totalmente integralizada à estação de trabalho. Reg. Anvisa: 80123860005. Gerador de raios-x Multi-pulso 800mA → 800 mAs, Pannel de controle; Tubo de raios-x 300 KHU de alta rotação; Estativa porta-tubo; Bucky mural; Mesa com tampo flutuante; Estação de aquisição e trabalho e demais acessórios conforme apresentado nessa proposta; permite técnicas de Raios X nos modos Manual e Automático, Alarmes para falhas, Sistema digital com detectores de silício Amorfo e tela de conversão de Iodeto de Césio; Tamanho do pixel 140 microns; Profundidade de imagem de 16 bits/pixel; Gerador de Alta-frequência, microprocessado, Tensão de 40-150 kV, 20 - 800 mA - 0,25 a 800 mAs; Proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; Estação de trabalho 100% integrada ao gerador, com informações de técnica KV,MA, MAS e outras, no monitor da estação. Pannel de controle: Indicação digital de kV, mA, Sistema independente para ajuste do operador;Seleção de foco Fino e Grosso; Tubo de Raios-X com anodo giratório - alta rotação - foco fino/grosso 0,6/1,2 mm → alta capacidade térmica de 300 KHU alta rotação acima de 9.000 rpm → Marca IAE conforme manual da Anvisa. Estativa: Vertical tipo Chão-chão; Movimentos com o tubo de raios-x: Coluna com deslocamento longitudinal de aproximadamente 3,00 metros, Vertical 158,60 cm e altura máxima de 244 cm, Rotação de 180°, para exposições no bucky mural e projeções oblíquas na mesa retentores mecânicos nas posições 0°, 45° e 90°.Rotação da coluna toda ou do braço porta-tubo em 180°; Angulador do tubo digital; Freios eletromagnéticos para todos os movimentos; Grade antidifusora 103 linhas/pol. 10:1.Marcação em cruz para centralização do paciente; Sistema de freios eletromagnéticos; Mesa para Diagnóstico: Tampo flutuante, deslocamento nos 04 sentidos; Sistema de freios eletromagnéticos acionado por pedal; dimensões 228 cm x 91 cm; Capacidade de carga da mesa de 300 Kg; Permite os seguintes movimentos do tampo: Longitudinais de +-70 cm; Laterais de +- 24 cm aproximadamente; Distância foco/detector de 100 cm a 180cm;Colocação frontal de chassi ou detector; Grade antidifusora 103 l/pol:Razão 10:1; colimador luminoso com timer → 100 cm 160 lux; Estação de aquisição: Estação 100% integrada ao gerador do equipamento proporcionando a inclusão de parâmetros como KV e mAs nas imagens geradas e impressas; HW da estação de trabalho: Computador HP Processador i5, 3.2 GHz, placa de vídeo Integrada/ 8GB Ram; CD/DVD, SSD 256GB para dados + 1TB para imagens, placa de rede 10/100/1000 T-Ethernet, portas USB, teclado e mouse, monitor 24- de alta RESOLUÇÃO touch screen → sistema operacional win 10/11 pro 64 bits. 01 unidade - Placa Detectora Digital - painel plano (FPD): detector de silício Amorfo e tela de conversão de Iodeto de Césio (CSI); Dimensões da área útil de aproximadamente 35 cm x 43 cm(placa wifi) e 35 x 43 cm; Profundidade de imagem de 16 bits/pixel; Peso do detector → 3,20 kg aproximadamente com baterias. Suporta até 400 KG distribuídos, e possui grau de proteção IP 67, o maior grau de proteção do mercado - à prova total de água e outros líquidos, e poeira. Ideal para pacientes enfermos ou mesmo acidentados, onde urina e sangue são blindados graças ao seu alto grau de proteção(melhor placa comercializada no mercado é considerada a TOP mundial). Resolução de 140 microns. Memória interna para 200 imagens. Baterias internas de última geração e longa duração → 16 horas de operacionalidade sem necessidade de recarga.CONTINUA NA PROPOSTA

Endereço:
,



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC

R\$ 400.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Gerador64kW FaixadeKV40a150kVcomintervalode1em1KvTensõesdealimentação trifásico-380Volts?

60HzPotência máxima64kW Faixadema01a800mAsFaixadema10a800mATempodeexposição0001até5sMesaDimensõesdotampo90x218cmLxCDeslocamentolongitudinal±72cmTotalde144cmDeslocamentotransversal±12cmTotalde24cmAlturadotampo83cmCapacidadedetrabalho220kgDeslocamentolongitudinaldobucky58cmFreiodomovimentodotampo eletromagnéticopedalTamanhomáximodochassi43x43cmFoco100a180cmGradefixaantidifusora101103linhas/polegadaBuckyMuralDeslocamentovertical138cm36a174cmFreiod omovimentodobuckyeletromagnéticoTamanhomáximodochassi43x43cmCruzdelocalização/centralizaçãoimpressanotampoFoco100a180cmGradefixaantidifusora101?

103linhas/polegadaEstativaPortaTuboDeslocamentolongitudinal±185cmTotalde370cmDeslocamentoverticaldobraçoportatubo152cmFreiodosdeslocamentoseletromagnéticoTipo chão-chãoRotaçãodacoluna360ºeixohorizontalGirodacúpula±180ºeixoverticalTubodeRaiosX?

Canon/ToshibaTensão máxima150kV Focos06mmfinoe12mmgrossoPotênciareferência doânodo27kWfocofino/75kWfocogrossoCapacidadetêrmicadoânodo300kHU210kJRotação doânodo9700rpmColimadorManualaajustávelindicandoaregiãoaser irradiadaLâmpadacomtemporizador eletrônicode30sparadesligamentoautomáticoFiltração inerente2mmAlIllumi naçãoLEDProteção para150kVTrilhoparainserçãodefiltrosadicionaisdeCUouALSistemadefocalizaçãoe centralização Ângulação paradieta/esquerdaDetectorDRDetectorwirelessc omcintiladordelodetodeCésioCsIIImagensemaltaresoluçãoTamanho14"x17"superlevesando apenas18kgincluindo capacitorResolução espacial50lp/mmResistênciaãdobradeaté130kgCargamáximolateraladistribuidasobreasuperfíciededetectorde400kgResistênciaalíquidosepoeiraIP56comfontedealimentaçãointegradaConexãoAeroSync®ConversãoA/D16bitsTamanhodamatriz3488x4256100?mPré-

visualizaçãodaimagemem~2segundosImagemfinalde4a7segundosdependendodotamanhodopixeledaconexãodogeradorCapacitordeíonsdelítiocomofontedeenergiamcomcapacidade mínimade41horasdexamesou150imagensTempoderecarga13minutosEstação deaquisiçãoCS-

7Plataformaintuitivaedefáciloperaçãoapresentaferramentasbásicaseavançadasdemanipulação dasimagensPossuiinterfacesensívelaotoquecomcomunicação comossistemasRISePAC SviaDICOM30ContatambémcomoexclusivosoftwaredeprocessamentodeimagemRealismqueproporcionaummelhorníveldenitidezdetalhamentodasimagensdeRaiosXpormeiodoa primoramentodocontrasterevelandoaspectosanatômicossutismesmonasestruturasmaiscomplexasCommelhoriasnaqualidadedaimagemoRealismaumenta aeficiênciade fluxodetrabal hoopermitiravisualizaçãodetecidosmoleseestruturasósseassimultaneamentereduzindoquantidadedeajustespeloperadorCPU-Corei3-8GBdeRAM-500GBdeHD-

Windows1064bits-

tecladoemouseCapacidadedearmazenamentodeaproximadamente100000imagensMonitorde23polegadas touchscreenConectividadeDICOM30DICOMStorageDICOMPrintDICO MSendDICOMWorklistDICOMMMWmparaconexãoRISeHISDriveCD/DVDparagravaçãodemídiaexternaConversãodaimagemparaformatoJPEGBackupprestauraçãoeexportaçãode imagensemmdiasexternasCDDVDUSBConfiguraçãodosprotocolosde aquisiçãoe processamentopordiferentesregiõesanatômicasMedidasdedistânciaeânguloEliminação daslinhasd egradeInserçãodeaté50textospredefinidosoueditadosAnotaçãossobreimagemColimaçãoeletrônicaMagnificaçãozoomdaimagemcommovimentaçãoVisualizaçãomelacheiaRotaçã omovimentaçãoe inversãodaimagempositivo/negativoAjusteindependentedospâmetrosdelatitudedecontrastebrihoeffiltroespacialEscurecimentoautomáticodaimagemmáscaraRecor tedaimagemnotamanhoenaposiçãoespecificadopelousuárioImpressãodeaté25imagensporpelículaAcessoaosistemaatravésdeloginsenhaCONFIGURAÇÃOGERALEquipamentodeRXdigitalAltusDRSL Mesabuckyo Muralbuckyo Estativaportatubo

GeradorAltusDRTubodeRX150kVoPardecabosdealtatensãoControleAutomáticodeExposiçãoAECcom3câmarasdeionização compatívelcommesaemuralbucky Dispositivodemediçãodoprodutoárea-doseDAPoAeroDRDRSL14x17 BatteryCharger2o Estação de comandoCS-7CP

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 285.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ

Data: 05/04/2024 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO RAO - X FIXO DIGITAL COM IMPRESSORA PARA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPÊ

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: RAO - X FIXO DIGITAL COM IMPRESSORA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA - RAO - X FIXO DIGITAL COM IMPRESSORA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Identificação: 00002224

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 09/04/2024 00:00

Fonte: scp. iiepe.dcfiorilli.com.br:879/transpar encia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

51.577.256/0001-05

IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 285.000,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 245.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE ACREUNA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamento Hospitalar, Utensílios Médicos, Odonto, Laboratorial e Diversos Materiais Permanentes para Manutenção das ações DP Médico e Alta Complexidade - MAC.

Descrição: **RAIO X MÓVEL DIGITAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOSX: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 40 KW; EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO; COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS OU NÃO; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE INTEGRADO À INTERFACE DO SISTEMA; O EQUI - RAIO X MÓVEL DIGITAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOSX: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 40 KW; EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO; COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS OU NÃO; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE INTEGRADO À INTERFACE DO SISTEMA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR INTEGRAÇÃO NATIVA DE FÁBRICA ENTRE O SISTEMA DIGITAL E O SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM COM A FINALIDADE DE INCLUIR, DE FORMA AUTOMÁTICA E SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO USUÁRIO, NO CABEÇALHO DICOM DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DIGITAIS A CARGA DOS PARÂMETROS KV, MA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO EOU MAS E A DOSAGEM APLICADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME GY. KV PARA RADIOGRAFIA DE 50 KV OU MENOR A 130 KV OU MAIOR, COM PASSO DE 1KV; MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 500 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 20 MAS OU MENOR A 280 MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 2 MS OU MENOR; ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADE SELADA COLIMADOR DE 90 GRAUS; TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.000 RPM; FOCO DUPLO DE**

Data: 21/02/2024 08:01

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 02218683000183-1-000049/2024

Lote/Item: 1/23

Ata: N/A

Homologação: 18/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 245.900,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Lagoa Santa	R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, 400

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 245.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE ACREUNA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO, LABORATORIAL E DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DP MÉDICO E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.

Descrição: **RAIO X MÓVEL DIGITAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 40 KW; EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO; COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS OU NÃO; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE INTEGRADO À INTERFACE DO SISTEMA; O EQU - RAIO X MÓVEL DIGITAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 40 KW; EQUIPAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO; COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS OU NÃO; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE INTEGRADO À INTERFACE DO SISTEMA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR INTEGRAÇÃO NATIVA DE FÁBRICA ENTRE O SISTEMA DIGITAL E O SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM COM A FINALIDADE DE INCLUIR, DE FORMA AUTOMÁTICA E SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO USUÁRIO, NO CABEÇALHO DICOM DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DIGITAIS A CARGA DOS PARÂMETROS (KV, MA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E/OU MAS) E A DOSAGEM APLICADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME (?GY). KV PARA RADIOGRAFIA DE 50 KV OU MENOR A 130 KV OU MAIOR, COM PASSO DE 1KV; MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 500 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 20 MAS OU MENOR A 280 MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 2 MS OU MENOR; ROTAÇÃO DO CONJUNTO UNIDADE SELADA/ COLIMADOR DE 90 GRAUS; TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3.000 RPM; FOCO DUPLO DE**

Data: 21/02/2024 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 02218683000183-1-000138/2024

Lote/Item: 1/23

Ata: N/A

Homologação: 19/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.659.246/0001-03 *VENCEDOR*	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 245.900,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Lagoa Santa	R PREFEITO ELIZEU ALVES DA SILVA, 400





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Licitações-E

www.licitacoes-e.com.br

Data: 17/07/2024 10:43:37

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 04/07/2024 12:03:19

Acessar a fonte [aqui](#)

4 - Prefeitura Municipal de Iepê/SP

scpiiepe.dcfiorilli.com.br:879/transparencia/

Data: 12/07/2024 13:55:45

Acessar a fonte [aqui](#)





MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00089/2023 (SRP) - **Licitação abandonada** - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:15 horas do dia 06 de novembro de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 67215002925202264, Pregão nº 00089/2023.

Resultado da Homologação**Item: 1**

Descrição: Desfibrilador

Descrição Complementar: Desfibrilador Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Componente: Pás Externas E Adesivas , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Módulo: Portátil , Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Alimentação: Bateria Recarregável , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico , Memória: Grava Eventos

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 26.354,8000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: K R G BENTO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21.122,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: K R G BENTO LTDA, CNPJ/CPF: 18.932.464/0001-00, Melhor lance: R\$ 21.122,0000
Homologado	06/11/2023 16:15:54	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 4

Descrição: Aparelho anestesia

Descrição Complementar: Componentes: Fluxômetro Duplo P/ 02 E N2O E CO2, Tipo Volume: Fluxo Mínimo 50ml/Min De 02, Outros Componentes: Controle Hipóxico Mecânico, Iluminação Independente, Tipo: Compacto, Características Adicionais: Ventilador Microprocessado, Oxímetro, Eeg, Tipo Sistema: 3 Gases Integrados O2, N2o E Co2, Acessórios: Sobre 4 Rodízios Com Freios Nas Rodas Frontais,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 340.450,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: MTB TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 116.800,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.405.834/0001-40, Melhor lance: R\$ 116.800,0000
Homologado	06/11/2023 16:16:06	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 5

Descrição: Máquina de diálise

Descrição Complementar: Tipo Ajuste: Ultrafiltração Sequencial Automatizada, Componente: Controle Temperatura, Ultrafiltração, Controle Ptm, Tipo: Sistema Volumétrico, Variação De Proporção, Tipo Medição: 0-300-500-800ml/Min, , Escalas Monitorar Solução,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67.328,8800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 56.000,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 13.333.090/0011-56, Melhor lance: R\$ 56.000,0000
Homologado	06/11/2023 16:16:18	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 6**Descrição:** Ventilador artificial eletrônico**Descrição Complementar:** Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão, Modelo: Neonatal, Tipo 01: Transporte, Modos Ventilação: Vcv, Simv,Cpap,Ps, A/C, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Alarmes: Alarmes Audiovisuais,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 54.933,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A , pelo melhor lance de R\$ 54.890,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54, Melhor lance: R\$ 54.890,0000
Homologado	06/11/2023 16:16:27	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 7**Descrição:** Cabine segurança biológica**Descrição Complementar:** Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corredixa,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo: Tipo A2,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 66.268,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 40.095,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.587.270/0001-00, Melhor lance: R\$ 40.095,0000
Homologado	06/11/2023 16:16:28	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 8**Descrição:** Pistola**Descrição Complementar:** Material: Aço, Alumínio E Teflon, Uso: Para Agulha Centimetrada, Ponta Ecogênica, Tipo De Acionamento: Trava Segurança, Avanço Mínimo Agulha 25mm, Tipo: Biópsia Tecidos Moles, Características Adicionais: Sistema Automático, Gatilho Frente/Trás, Compatibilidade: Tomografia Computadorizada,Ultrasom E Mamografia, Tipo Uso: Autoclavável, Tipo Ação: Retira Amostra Sem Retirar Agulha,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.428,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/11/2023 16:03:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56, Melhor lance: R\$ 10.000,0000
Homologado	06/11/2023 16:16:40	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 9**Descrição:** Desfibrilador**Descrição Complementar:** Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas, Componente: Pás Externas E Adesivas, Tipo Onda: Bifásica, Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias, Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo, Tipo Módulo: Portátil, Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual, Alimentação: Bateria Recarregável, Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico, Memória: Grava Eventos,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.354,8000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	06/11/2023 11:20:57	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por solicitação do setor técnico para revisão do Termo de Referência
Homologado	06/11/2023 16:16:51	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 10
Descrição: Máquina de diálise
Descrição Complementar: Tipo Ajuste: Ultrafiltração Sequencial Automatizada, Componente: Controle Temperatura, Ultrafiltração, Controle Ptm, Tipo: Sistema Volumétrico, Variação De Proporção, Tipo Medição: 0-300-500-800ml/Min, , Escalas Monitorar Solução,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 67.328,8800
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	06/11/2023 11:21:09	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por solicitação do setor técnico para revisão do Termo de Referência
Homologado	06/11/2023 16:17:00	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Item: 11
Descrição: Ventilador artificial eletrônico
Descrição Complementar: Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão, Modelo: Neonatal, Tipo 01: Transporte, Modos Ventilação: Vcv, Simv,Cpap,Ps, A/C, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Alarmes: Alarmes Audiovisuais,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 54.933,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	06/11/2023 11:21:36	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por ausência de propostas válidas.
Homologado	06/11/2023 16:17:12	ANTONIO CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o Relatório

Voltar

